

Ilustríssimo Senhor (a), Responsáveis da Comissão de Compras e Licitações do Município de Catalão - go.

Ref.: Ao pregão presencial 007/2021. Processo 2021003102 Formação de registro de preço, que irá acontecer dia 07/05/2021 às 09:00.


**Objeto:** Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Equipamentos para Lavanderia Hospitalar, Material Médico Hospitalar e Mobiliário para atender a Secretaria Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde de Catalão - Go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos

PRÓ SAÚDE DISTRIBUIDORA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 34.849.278/0001-50, com sede na AV. V8, S/N QD. 10 LT. 01 MANSÕES PARAÍSO, APARECIDA DE GOIÂNIA - GO , por seu representante legal, tempestivamente, vem, manifestação de impugnação do edital referente ao direcionamento referencial do item 16 (CONJUNTO DE BISTURI PARA CIRURGIA DO TRATO GENITAL INFERIOR + MEGAPULSE + ASPIRADOR A VÁCUO ).

Em relação à frequência ser de acima 450kHz, isso é uma particularidade de cada fabricante, o nosso é 400kHz. No entanto, se o motivo de nossa desclassificação for essa frequência de 450kHz essa digníssima comissão estará direcionando esse equipamento de pequeno porte para um determinado fornecedor

*\*Em resposta que a frequência deve ser acima de 450kHz:*

Observando o espectro eletromagnético conforme figura abaixo (informação que pode ser retirada de que qualquer livro didático), Radiofrequência(RF) é a faixa de frequência que abrange aproximadamente de 3kHz a 300GHz e que corresponde a frequência das ondas de rádio (fonte: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Radiofrequencia>), dessa forma as ondas de 400khz e 480khz estão dentro da faixa de rádio frequência.

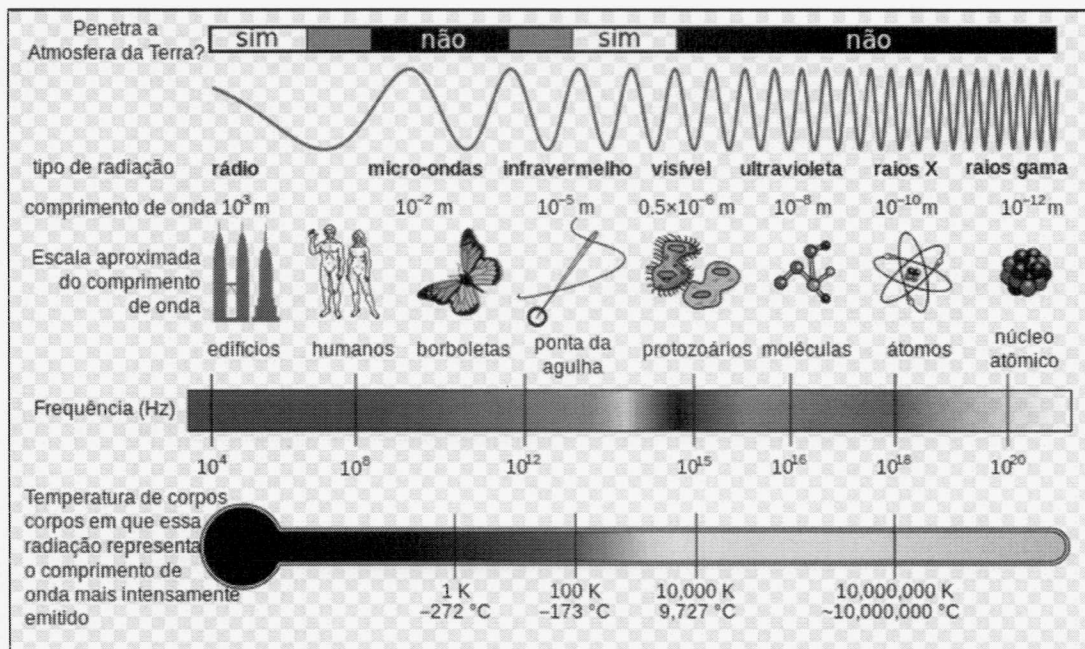

Fonte: [https://pt.wikipedia.org/wiki/Espectro\\_eletromagn%C3%A9tico](https://pt.wikipedia.org/wiki/Espectro_eletromagn%C3%A9tico)

Devido as particularidades na elaboração do projeto eletrônico cada fabricante de bisturi tem suas características próprias, e por isso, quando comparados a outros, não são idênticos, porém gera o efeito terapêutico desejado, por exemplo:

EMPRESA	EQUIPAMENTO	FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO
Deltronix	Precision TC3	400Khz
ERBE	Vio300S	350Khz
Velleylab	Force FX	390Khz
Olympus	ESG-400	430Khz
WEM	SS-501S	480kHz
WEM	SS-501SX	390KHZ

Dessa forma a frequência de operação não pode ser motivo de desclassificação do nosso produto, caso contrário o descritivo desse edital será contemplado por apenas **UM** equipamento de **UM** fabricante específico, devido a unidade de frequência que deveria contemplar uma faixa de 3kHz a 300GHz (rádio frequência) para aceitação

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO:

**PROLIFE**  
tecnologia a serviço da medicina


**NOVITECH**  
Equipamentos Médicos Ltda.

Em relação à “ MEGAPULSE HF FRAXX” está direcionando esse equipamento de pequeno porte para um determinado fornecedor.

Manual de instruções multimídia em português. MEGAPULSE HF FRAXX - o efeito termal de uma corrente de baixa frequência pode produzir reações teciduais indesejáveis como cicatrizes hipertróficas e queloides. Para evitar estes efeitos, o bisturi

página.9

- Quando se digita essa referencia que está descrita no item, observa-se o direcionamento para uma marca específica.

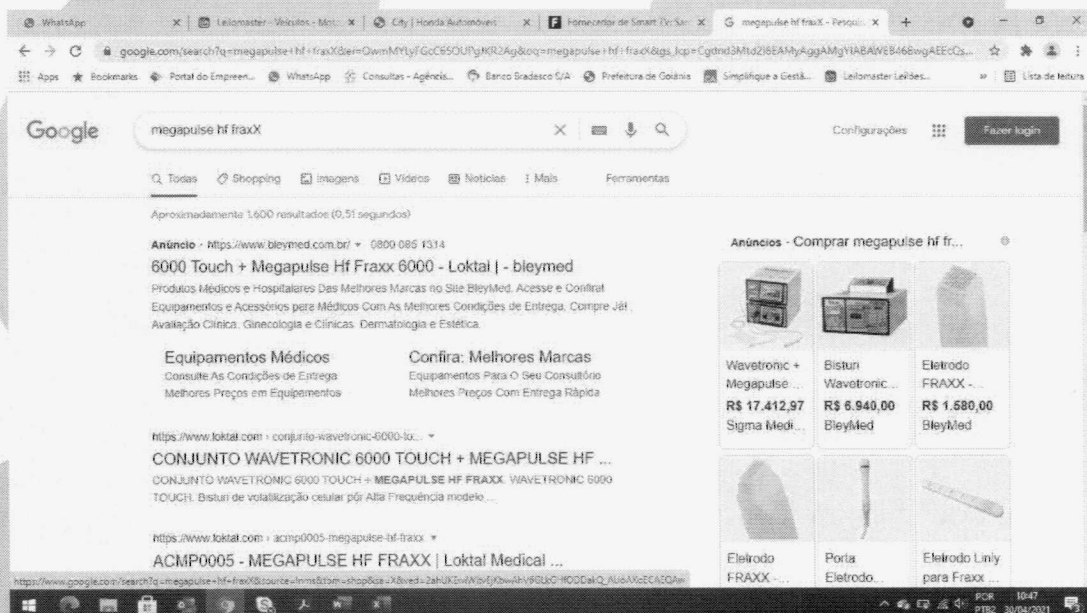

Fonte;


[https://www.google.com/search?q=megapulse+hf+fraxx&ei=OwmMYLyFGcC65OUPgJKR2Ag&oq=megapulse+hf+fraxx&gs\\_lcp=Cgndd3Mtd2l6EAMyAggAMgYIABAWEB46BwgAEEcQsAM6BAGAEA1QiQ1YmkhgmVZoAnAcEACAAMZMBiAHSCZIBAZAuOZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&scilnt=gws-wiz&ved=0ahUKEwj8jvu-jKbwAhVAHbkGHQBjBIIsQ4dUDCA4&uact=5](https://www.google.com/search?q=megapulse+hf+fraxx&ei=OwmMYLyFGcC65OUPgJKR2Ag&oq=megapulse+hf+fraxx&gs_lcp=Cgndd3Mtd2l6EAMyAggAMgYIABAWEB46BwgAEEcQsAM6BAGAEA1QiQ1YmkhgmVZoAnAcEACAAMZMBiAHSCZIBAZAuOZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&scilnt=gws-wiz&ved=0ahUKEwj8jvu-jKbwAhVAHbkGHQBjBIIsQ4dUDCA4&uact=5)

## DO PEDIDO

Em face do exposto, requer-se o provimento do presente recurso, com efeito para:

- Com fundamento do art.49, da Lei n 8666/93, retirar tal “ referencia ( MEGAPULSE HF FRAXX) “ do descritivo no item, para que tenha a ampla concorrência legal.
- Determinar-se à Comissão de Licitação que profira tal julgamento, considerando outras marcas para alcançar o competente resultado

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO:



classificatório, o qual, por certo, resultará na adjudicação do objeto licitado de forma limpa e transparente

Outrossim, amparada nas razões recursais, requer-se que essa Comissão de Licitação, na hipótese não esperada disse não ocorrer, faça este subir à autoridade superior em consonância com o previsto no § 4º, do art. 109, da Lei nº 8666/93, comunicando-se aos demais licitantes para as devidas impugnações, se assim o desejarem, conforme previsto no § 3º, do mesmo artigo do Estatuto.

Nestes Termos

P. Deferimento

Atenciosamente,

APRECDIDA DE GOIANIA, 30 de ABRIL de 2021.



Representante Legal : Uiatã Ribeiro Momente  
CPF: 006.493.381-46 RG: 4737612 DGPC-GO

**34.849.278/0001-50**

**PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI**

AV. V8 QD. 10 LT. 01 -

MANSÕES PARAISO

CEP: 74.952-560

APARECIDA DE GOIÂNIA-GO

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO:

 **PROLIFE**  
Tecnologia a serviço da medicina

 **NOVITECH**<sup>®</sup>  
Equipamentos Médicos Ltda.